

 Operating Instructions

 Mode d'emploi

 Bedienungsanleitung

 Brugsanvisning

 Handleiding voor de Bediening

 Bruksanvisning



Bruksanvisning



Instrucciones de funcionamiento



Instruções para Utilização



Instruzioni per l'uso



Οδηγίες Λειτουργίας



Clinical Autoclaves



P3 -Decals, displays and controls  
 P4 -Introduction  
   -*Key to Pictures*  
 P5 -Getting Started  
 P6 -Continued Operation  
 P7 -Troubleshooting  
 P8 -Technical Specification  
 P9 -Additional Information



S3 -Dekaleringer, display og kontroller  
 S40 - Introduksjon -Bildeforklaring  
 S41 -Igangsætting  
 S42 -Fortsatt bruk  
 S43 -Feilsøking  
 S44 -Teknisk spesifikasjon  
 S45 -Ytterligere informasjon



P3 -Autocollants, panneaux et commandes  
 P10 -Introduction -Légendes des images  
 P11 -Prise en main  
 P12 -Fonctionnement continu  
 P13 -Dépistage des anomalies  
 P14 -Caractéristiques techniques  
 P15 -Renseignements complémentaires



P3 -Calcomanías, visualizadores y controles  
 P46 -Introducción -Clave a las fotografías  
 P47 - Preparación para el funcionamiento  
 P48 - Funcionamiento continuo  
 P49 - Localización de averías  
 P50 - Especificaciones técnicas  
 P51 - Información adicional



S.3 -Symbole, Anzeigen und Bedienungselemente  
 S.16 - Einleitung -Zeichenerklärung zu Bildern  
 S.17 -Inbetriebnahme  
 S.18 - Kontinuierlicher Betrieb  
 S.19 - Fehlererkennung und Beseitigung  
 S.20 - Technische Daten  
 S.21 -Weitere Informationen



P3 -Dísticos, mostradores e comandos  
 P52 -Introdução -Legendas das imagens  
 P53 -Como começar  
 P54 -Funcionamento prolongado  
 P55 -Resolução de problemas  
 P56 -Especificações Técnicas  
 P57 -Informação Adicional



S3 - Mærkatør, displays og betjeningsanordninger  
 S22 -Indledning -Nøgle til billeder  
 S23 -Sådan kommer man i gang  
 S24 -Fortsat drift  
 S25 -Fejlfinding  
 S26 -Tekniske specifikationer  
 S27 -Supplerende informationer



P3 -Decalcomanie, display e comandi  
 P58 -Introduzione -Legenda delle illustrazioni  
 P59 -Procedura di Avviamento  
 P60 -Funzionamento Interrutto  
 P61 -Ricerca dei Guasti  
 P62 -Specifiche Tecniche  
 P63 -Ulteriori Informazioni






P3 - Gegevensplaatjes, weergaven en bedieningsknoppen  
 P28 - Inleiding  
   Verklaring van illustraties  
 P29 - Beginnen  
 P30 - Continu gebruik  
 P31 - Diagnoseprocedure  
 P32 - Technische specificaties  
 P33 - Aanvullende informatie



Σ3 Χαλκμανες, ενδεεις και ειριση  
 Σ64 -Εισαγωγη-Οδηγης εικνων  
 Σ65 -Πις αρετε  
 Σ66 Συνες λεπυργα  
 Σ67 Λση πρλημτων  
 Σ68 -Τενικης πρδιαγρας  
 Σ69 Συμπληρωματικης πληρρες



Sida 3 - Dekaler, display och reglage  
 Sida 34 - Inledning -Bildforklaring  
 Sida 35 - Förberedelser  
 Sida 36 - Fortsatt användning  
 Sida 37 - Felsökning  
 Sida 38 - Tekniska data  
 Sida 39 - Tillkommande information

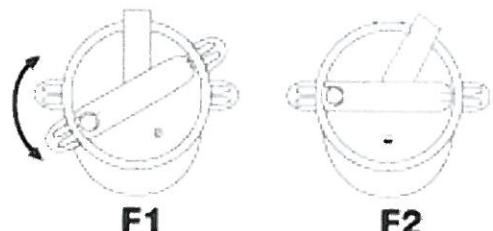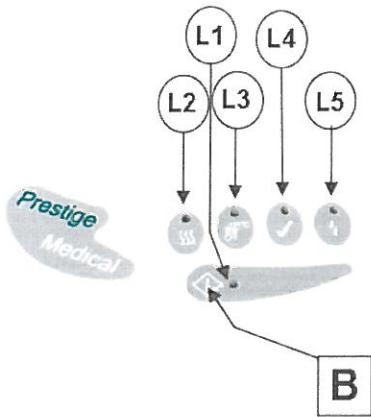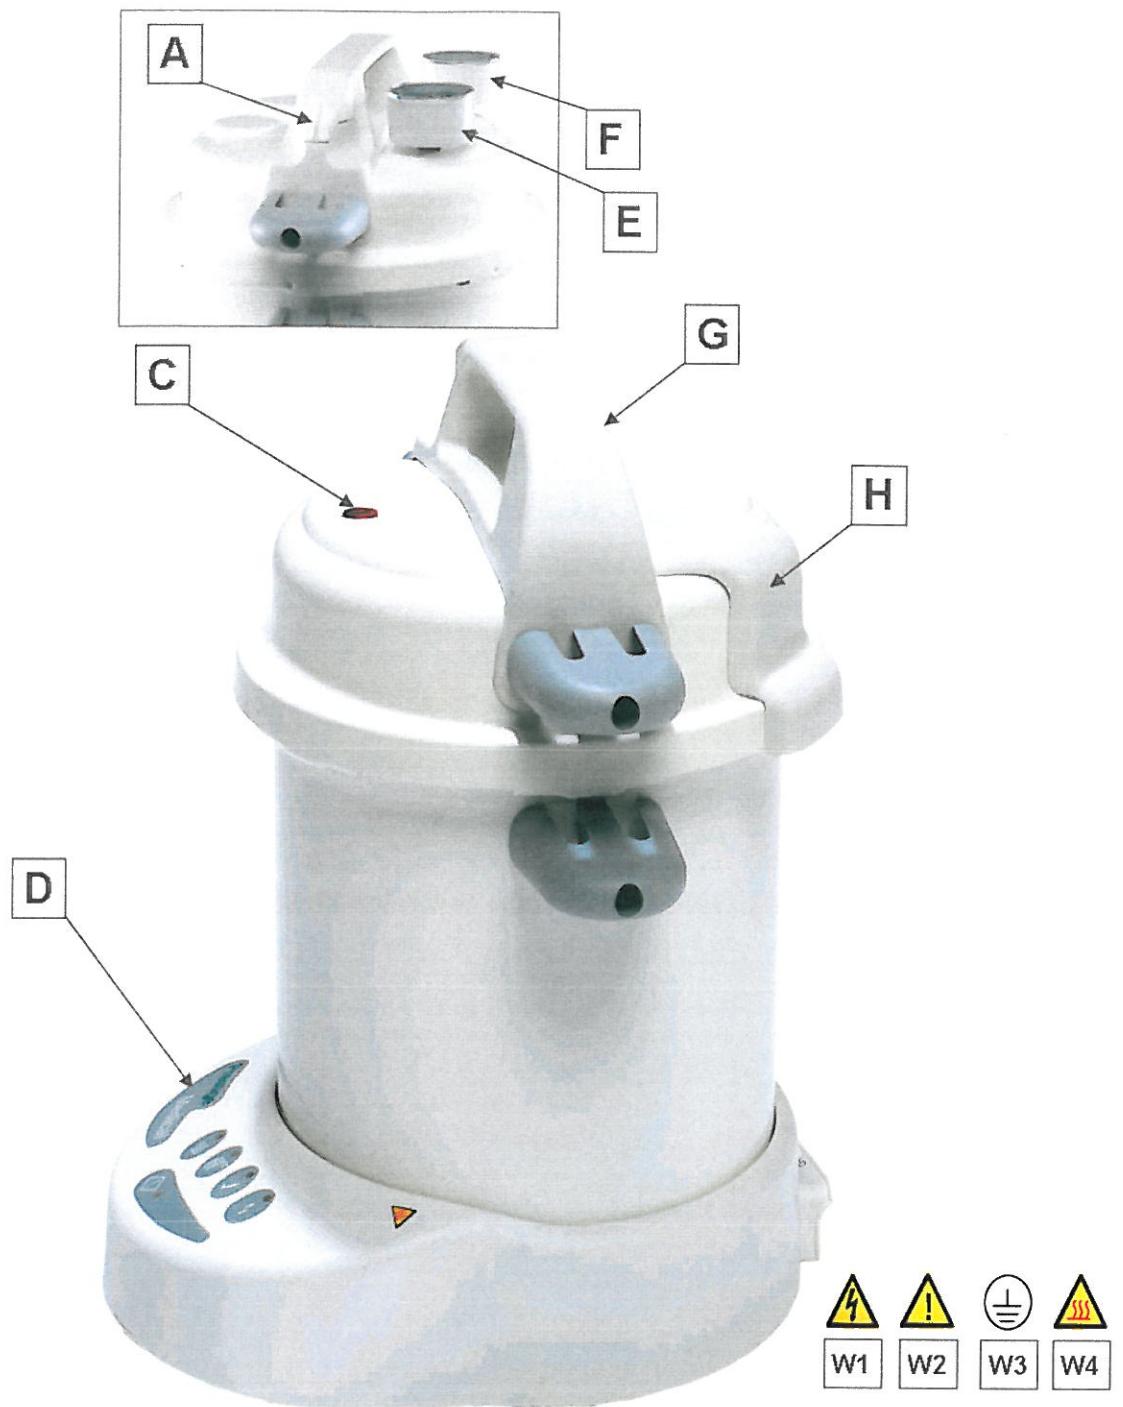

**Introduktion**

Vi tackar för det förtroende ni visat genom att välja 2100 Classic autoklav, konstruerad för att sterilisera massiva ej omvälvade instrument. Efter uppackningen, var vänlig kontrollera om transportskador inträffat. Om så är fallet, kontakta omedelbart er leverantör.

Tillsammans med denna enhet levereras följande:

- Nätsladd Instrumentmöbel
- Certifikat angående prestandatest
- Efterlevandecertifikat
- Registreringskort för garanti

**Tolk till dilder, diagram och symboler****Reglage:**

- A - Trycksänkningsventil
- B - Startknapp arbetscykel
- C - Tryckstegningsindikator
- D - Displaypanel
- E - VIRKER Tryck Dimension ("Plus" modellerna bara)
- F - Temperatur Dimension ("Plus" modellerna bara)
- G - Topp Handtag VARNINGEN HOTPART! – Inte röra den topp Handtag omgående efter en cykel. Nyttade inte till öppen locken. Bar den autoclave när Het.
- H - Ånga Duct – VARNINGEN HOTPART! Täckande inte

**Indikeringslampor:**

- L1 - "Ström på" -GRÖN
- L2 - Uppvärmning -ORANGE
- L3 - Sterilisering -GUL
- L4 - Sterilisering avslutad - GRÖN
- L5 - Felindikator - RÖD

**Varningssymboler:**

- W1-Se upp för stranstöt
- W2-Varning! Läs handboken innan autoklaven används
- W3-Varning! Apparaten måste vara jordad
- W4-Varning! Risk för brännskada

**Figurer:**

- F1 -Locket passas in med huset. vrid medurs för att stänga
- F2 -Locket i stängt läge

**VARNING!**

Rör inte vid huset eller locket, dessa delar blir heta medan autoklaven är i funktion.

Innan autoklaven används för första gången, ta dig tid att läsa igenom följande sidor så att du bekantar dig med användningen av enheten. Vi rekommenderar & det starkaste att alla som använder autoklaven ska vara utbildad på funktionerna och driften av den. Autoklaven är enkel att använda. Genom att följa den enkla driftssekvensen tillsammans med bilderna på autoklaven, reglagen, instrumentpanelen och symbolerna (sidan 3) kan du försäkra dig om att instrumenten blir korrekt steriliseraade varandra gång.

**VARNING!****Nätuttaget MÄSTE VARA JORDAT.**

Nätkontakten måste alltid vara lätt åtkomlig, eftersom det är den viktigaste frankopplingsanordningen.

**1. Vatten**

Fyll enheten till nivåmarken på kammarens insida med 0,75 l destillerat eller avjoniserat vatten (S1).

**ANVAND INTE KRANVATTEN OCH FYLL INTE PÅ FÖR MYCKET VATTEN**

**2. Laddning (massiva instrument)**

Placera ENDAST TVÄTTADE instrumenter UTAN OMSLAG plus en TST-remsa i instrumentkorgen eller kassetterna och lägg på plats i enheten.

TST-remsorna måste placeras så nära mitten av arbetsstyckena som möjligt.

**VARNING!**

Tillverkarna bor tillfrasgas om deras instrument lämpar sig för autoklav samt vilka maximala temperaturer de tar.

**3. Stängning**

Placera alltid locket på autoklaven med trycksänkningsventilen (A) öppen.

Passa ihop locket och huset (F1) och vrid medurs så att locket stängs helt (F2).

Stäng trycksänkningsventilen (A) så att den riktas in med "O" på locket.

Lämna den aldrig i den position som visas i F1.

**4. Anslutning**

Stick in kontakten på sladden på enheten baksida i ett JORDAT uttag med KORREKT spänning.

Lampor: L1 tänds GRÖNA

**5. Start**

Starta steriliseringcykeln genom att trycka på knappen (B)

Lampor: L1 tänds GRÖNA

L2 tänds ORANGE

- i takt med att temperaturen stiger ersätts luft med ånga genom att luften strömmar ur trycksänkningsventilen i locket till dess att den stängs med ett hörbart "klick", vilket förseglar enheten.

Tryckindikatorn (C) stiger vilket anger att enheten är trycksatt.

- Steriliseringstemperaturen är uppnådd när

Lampor: L1 tänds GRÖNA

L2 blinkar ORANGE

L3 tänds GUL

- Steriliseringcykeln är fullbordad när:

Lampor: L1 tänds GRÖNA

L4 tänds GRÖNA

**6. Trycksänkning**

När steriliseringcykeln är fullbordad måste trycket i enheten sänkas och enheten måste svälva innan locket kan öppnas och de sterila instrumenten plockas ut.

Den tid som detta tar innan det kan utföras riskfritt kan minskas genom att enheten trycksänks manuellt.

Öppna trycksänkningsventilen (A) genom att sakta vrida den motsols\*

Tryckindikatorn (C) sjunker när ångan släpps ut

\* Varning! Där vilja bli en visuell och horbar frige av ånga från foda upp om Ånga Duct H).

**7. Uppläsning**

När temperatur och tryck nått en säker nivå kan locket läsas upp. Se till att trycksänkningsventilen (A) är öppen. Skruva av locket genom att vrida det motsols till dess att pilarna (F1)

**8. Urlockning**

Lyft av locket och placera det försiktigt upp och ned på en massiv arbetsyta och låt det svälva. Se till att trycksänkningsventilen (A) är stängd så att den inte skadas.

Enheten har fullbordat en framgångsrik sterilisering. TST-remsan helt bytt färg från gul till lila

Korgen eller kassetterna med steriliseraade instrument kan nu lyftas ut ur enheten.

Undvik skador genom att sätta på locket enligt beskrivning i steg 3

\* Var god lägg märke till att om punkten inte fullständigt bytt färg ska en ny TST-remsa läggas i korgen och steriliseringen måste sedan göras om. Om punkten även denna gång inte fullständigt byter färg ska enheten inte användas förrän den kontrollerats av en kvalificerad tekniker.

**ANVÄND INTE INSTRUMENTEN OM EN KOMPLETT STERILISERINGSCYKEL INTE GENOMFÖRTS.**

**Fortsatt drift**

För att se till att er autoklav ger de årlats tjänstgöring som den är konstruerad för är det viktigt att komma ihåg några få "Gör" och "Gör inte" när det gäller användning av enheten och att utföra det enkla underhållet varje vecka.

**Se till att...**

- 1....läsa instruktionerna och alltid följa arbetssekvensen.
- 2....den arbetsyta där du ställer autoklaven är plan och stabil.
- 3....instrumenten är konstruerade för att tåla val steriliseringstemperatur, att de är helt rengjorda och avskilda innan steriliseringen, att de inte är längre än vad som får plats och att de inte överstiger angiven maxvikt - se avsnittet "Tekniska data".
- 4....vattnen i vän uppriphålls regelbundet endast med rent destillerat eller avioniserat vatten.
- 5....enheten är placerad dragfritt och minst 250mm från närmaste vägg.
- 6....endast använd grön packning (219500) och att denna **!** kasseras när den är utjänt, synbarligen skadad eller om den krympt. "Se fel 5".
- 7....locket är ordentligt stängt när enheten inte används, så att risken för olycksbetingade skador undviks. Lämna den aldrig i läge (F1)
- 8....ange modellens detaljer, serienummer och inköpsdatum vid kontakt med Prestige Medical eller leverantören.

**Se till att inte...**

- 1....Berör inte enheten när den arbetar - den är HET.
- 2....Forsök inte ta av locket när enheten arbetar. 3....tappa bort denna handbok. 4....tillsätta några som helst kemikalier i vattnet. 5....försöka sterilisera lättflyktiga ämnen, giftiga ämnen eller inkorrekt laster.
- 6....placera enheten på värmekänsligt underlag som polerat trä eller glas.
- 7....öppna trycksänkningsventilen (A) under steriliseringssyklén.
- 8....lämna trycksänkningsventilen (A) öppen när locket placeras upp och ned på en arbetsyta.
- 9....sänka ned enheten eller nätsladden i vatten vid rengöringen.
- 10..använda slipande material eller smörjmedel vid rengöring
- 11..tappa eller slå på enheten
- 12..använda enheten på platser där det finns risk för lättantändliga material eller gaser.
- 13..byta säkring innan sladden drags ur. Endast kvalificerade personer ska byta säkringar.
- 14..sträcka dig över enheten när locket lyfts av, att göra det innebär risk för brännskador från uppstigande värme och ånga.
- 15..trycka på startknappen när cykeln startats eftersom detta nollställer timern.

**Underhåll.****VARNING!**

Koppla ifrån nätströmmen från apparaten före rengöring.

**Röd packning**

- 1 Lässa från lockets insida och rengör med varmt tvålsvatten.
- 2 Skölj noga och skaka torr, torka inte av den.
- 3 Sätt tillbaka i locket genom att trycka in den jämnt fördelat under samtliga klackar, börja vid säkerhetsventilen. Packningen kan se något skrynklig ut innan den anvants.
- 4 Byt ner den när den börjar visa tecken på lackage.

**Autoklav**

- 1 Om en ny packning läcker eller en enskild läcka uppstår, rengör då försiktigt husets och lockets tömningsytor med Scotchbrite, se till att inte ta bort någon metall. Skölj ytorna men torka dem inte.
- 2 Rengör in- och utsidorna med varmt tvålsvatten och se till att hålla elektriska delar torra.
- 3 Övervaka den första cykeln för dagen för att kontrollera att avlutförningsventilen på lockets insida stänger med ett hörbart klick.
- 4 Prestige Medical rekommenderar att enheten kalibreras var sjätte månad.
- 5 Smörj undersidan av klackarna på huset med vaselin om locket kärvar.  
**SMÖRJ INTE PACKNINGEN**

I händelse av att fel uppstår under koming, spåra felet med hjälp av beskrivningarna nedan. Åtgärda sedan felet enligt tillämplig anvisning.

**Felindikation/beskrivning/&tgörd****Fel 1: Ingen ström**

Lampor: L1 tänds inte  
Brunnen säkring / defekt kontakt / ej ansluten

Kontrollera att sladden är inkopplad

Kontrollera / byt säkring

Kontrollera att ström kommer fram till uttaget

**Fel 2: Låg vattenstånd eller torrkakning**

Lampor: L5 blinkar RÖTT

Låt enheten svalna innan vatten fylls på till rätt nivå

Dra ur och stick in kontakten och upprepa cykeln

Om felet upprepas vid korrekt vattenstånd, tillkalla servicetekniker.

**Fel 3: Sterilisering ej utförd**

Lampor: L4 tänds inte GRÖN och summern avger inget ljud

Dra ur och stick in kontakten och upprepa cykeln

Om felet upprepas, tillkalla servicetekniker.

**Fel 4: Ej komplett sterilisering**

TST-remsan byter inte färg, helt eller delvis.

Kontrollera remsans båst före datum

Dra ur och stick in kontakten och upprepa cykeln

Om felet upprepas, tillkalla servicetekniker.

**Fel 5: Ånga eller vatten läcker från locket**

i) Sliten eller smutsig packning

Tväta packningen enligt anvisningarna i "Underhåll".

Om felet uppträder igen, byt packning.

ii) Felaktig stängning av locket

Se till att enhetens tryck helt släpps ut genom att öppna trycksänkningsventilen(A).

Ta av locket och sätt på det korrekt.

Dra ur och stick in kontakten och upprepa cykeln

**Fel 6: För mycket ånga eller vatten från**

trycksänkningsventilen (A).

Trycksänkningsventilen (A) är öppen  
Stäng trycksänkningsventilen (A)

**Fel 7: Felaktiga mätaravläsningar.\***

\*Endast tillämpligt på "Plus" modeller.

Dra ur och stick in kontakten och upprepa cykeln

Om felet upprepas, tillkalla servicetekniker.

**Säkerhetsfunktioner**

- 1 På baksidan av locket, under höljet finns en fjäder som är konstruerad för att förhindra att trycket byggs upp om locket monterats fel.  
**RÖR INTE DENNA SÄKERHETSANORDNING**
- 2 Om temperaturen av någon orsak sjunker under minimikravet för sterilisering släcker steriliseringsslampan (L3) och cykelns timer startar om från noll när korrekt temperatur uppnås igen.
- 3 Om ett elektriskt eller elektroniskt fel resulterar i en tryckhöjning - över normalt arbetstryck - aktiveras en eller flera av följande säkerhetsfunktioner:

- i) Trycksänkningsventilen (A) släpper ut ånga snabbt och ljudligt.
- ii) Packningen sticker ut genom spåret på lockets baksida vilket snabbt släpper ut överskott av tryck och ånga. 
- iii) En icke återställbar termisk säkring i enhetens bas smälter vid en förbestämd temperatur vilket kopplar från strömmen.

**Tekniska data****-Autoklaver med standardhus**

Höjd	335 mm	Kapacitet	9 litres	Longueur maximale des instruments:	228 mm
Bredd	340 mm	Dimensions de la chambre interne (p/h):		Max lastvikt	3.0 kilos
Nettvikt	4.5 kilos		210/230mm		

**- Autoklaver 134°C**

Höjd	335 mm	Kapacitet	9 litres	Longueur maximale des instruments:	228 mm
Bredd	340 mm	Dimensions de la chambre interne (p/h):		Max lastvikt	3.0 kilos
Nettvikt	5.6 kilos		210/230mm		

**- Autoklaver med förlängt hus**

Höjd	420 mm	Kapacitet	12 litres	Longueur maximale des instruments:	290 mm
Bredd	340 mm	Dimensions de la chambre interne (p/h):		Max lastvikt	4.0 kilos
Nettvikt	4.5 kilos		210/270 mm		

**Säkringar** - Placerade under styrmodulen, F7.5A 32 x 6,3 mm, keramisk sandfyld. Kontaktsäkring (kan bytas av användaren), F13A enligt BS1362 ENDAST I

**Märkeffekt:** Alla apparater är avsedda för kontinuerlig belastning vid intermittent bruk.

**Hus** - Svarvat aluminium

**Lock** - Gjutet aluminium 121/126°C modellerna, 304 Rostfri stål på 134°C enheten bara

**Värmare** - Utvändigt monterat mekaniskt fixerat elektriskt element.

**Termobrytare** - Termosmältsäkring

**Tryck** - Primär ventil av proportionell typ, kalibrerad.

**Max enskaka feltemperatur** - 133,3°C  
(141,0°C på den 134°C modell)

**Överspänningskategori** - Grupp 11

**Föröreningsgrad** - Grupp 2

**Miljökrav** - inomhusbruk - upp till 2 000 meter höjd över havsnivå - omgivande temperatur 5°C till 40°C - maximal relativ luftfuktighet 80% för temperaturer understigande 31°C, därefter linjärt minskande till 50% vid 40°C.

-matningsspänningens variationer får inte överstiga +10% av nominell spänning

**Ingående strömanslutning** - Kontakt enligt IEC 302.

**Automatisk säkerhetsavstängning** - se "termobrytare" som endast ska återställas av en kvalificerad tekniker.

**Förpackningsmaterial** - allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.

**Övrig information****Reservdelar**

Använd endast de reservdelar som levereras eller specificeras av Prestige Medical vid underhåll av autoklaven. Användning av icke auktoriserade delar ogiltigförklarar samtliga garantier och kan allvarligt försämra utrustningens prestanda och sakerhet.

**Tillbehör**

Ett utbud med tillbehör för denna autoklav beskrivs nedan och visas på bild på sidan 70. Kontakta leverantören för mer information

- 1 - 219294 - lyftdon
- 2 - 219708 - Standardkorg
- 3 - 219291 - Instrumentkassett
- 4 - 219706 - Kassettskäll
- 5 - 219720 - Utökad instrumentkorg
- 6 - 219500 - Packning, grön silikon
- 7 - 259277 - TST indikatorremsor
- 8 - 219258 - Sladdsats UK
- 9 - 219299 - Sladdsats UL
- 10 - 219297 - Sladdsats EUROPA

**Garanti**

Prestige Medical ska, under de första 12 månaderna efter inköpsdatum gratis byta eller andra delar som visat sig vara defekta i material och/eller tillverkning. Endast värmeelementet täcks med livstids garanti.

Prestige Medical ska inte hållas ansvarigt i de fall köparen inte följer de medföljande instruktionerna eller om autoklaven missbrukas, tampus med, andras, repareras eller underhålls av icke auktorisera part. Detta kan även medföra att det inbyggda skyddsåtgärderna i utrustningen inte fungerar som avsett.

Packningen, intemat malmöng och förbrukningsmaterial täcks inte av denna garanti.

Kunders lagstadgade rättigheter påverkas inte.

**Rengöringsmaterial:**

- milt diskmedel
- rengöringskram utan slipmedel
- desinfektionsmedel utspätt med vatten (ej klorhaltigt)

**Dekontaminering av produkten.**

Om enheten kräver reparationer måste den dekontamineras enligt en vedertagen procedur innan den tas i drift igen. Ett meddelande om utrustningens kontamineringsstatus måste finnas tillgänglig med produkten. (Detaljer om lämplig procedur lämnas p& begäran).

**Godkännanden:**

Obs: Fråga om detaljerna kring godkännanden som är specifika för din modell. BS3970 Part 4 (pressure vessel only) CE Mark - Medical Device Directive (93/42/EEC)

**Förpackning.**

Allt packningsmaterial som används är återanvändbart, hantera det på lämpligt sätt.

OBSERVERA: Engelska är det ursprungliga språket för dessa instruktioner. Övriga språk är översättningar av den engelska texten.